



AED TRAINER DAEXAL

Mode d'emploi












- Merci d'avoir acheté l'AED Trainer DAEXAL
- Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser cet appareil.
- Veuillez également le conserver à portée de main pour référence future.

1. Présentation du défibrillateur	33
2. Défibrillateur	33

2.1 Contenu

Le Défibrillateur	44
2.2 L'écran d'affichage du défibrillateur	65
2.3 La télécommande.....	77
2.4 Accessoires	1111
3. Mode d'emploi	1111
3.1 Préparation.....	1111
3.2 Mise sous tension et sélection du mode d'entraînement.....	1212
3.3 Électrode de connexion	13Pad 13
3.4 Suivez les instructions vocales	1313
3.5 Réglage de l'interface	1414
3.6 Arrêt.....	1616
4. Maintenance du produit	1717
4.1 L'entretien du défibrillateur.....	1717
4.2 Entretien des électrodes	1717
4.3 Démontage et entretien de la batterie.....	1717
4.4 Condition de fonctionnement et d'entreposage	1919
5. Spécifications et contenu du défibrillateur	1919
5.1 Le défibrillateur.....	1919
5.2 Télécommande	1919
5.3 Contenu du défibrillateur.....	1919
6. Service après-vente.....	2121

Liste des symboles

	Date de fabrication
	Fabricant
	Ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers
	Reportez-vous au manuel d'utilisation
	Matricule
	Fragile
	Restez vers le haut
	Garder au sec
	Limite de température
	Limitation de l'humidité
	Limitation de la pression atmosphérique

1. Présentation du produit

Le défibrillateur AED (automatique externe défibrillateur) est spécialement conçu pour former le personnel de premiers secours avant qu'il n'utilise un véritable DAE clinique. Le défibrillateur DAE simule complètement le fonctionnement du DAE dans le guide de formation et le programme de formation, mais ne délivre pas de choc électrique à haute tension, protégeant ainsi la sécurité des stagiaires. Il peut être utilisé pour aider le personnel de premiers soins à se familiariser avec le DAE et à maîtriser certaines compétences opérationnelles de base nécessaires à l'utilisation du DAE dans le processus de premiers soins. Avant d'utiliser un DAE, le personnel de premiers secours devrait d'abord suivre des cours de formation sur la façon de réagir calmement en cas d'accident réel. Ces cours de formation comprennent également l'apprentissage de l'utilisation d'un défibrillateur. Un secouriste formé devrait savoir comment évaluer l'état d'un patient, comme la perte de conscience, l'arrêt respiratoire, l'arrêt cardiaque, etc., et devrait être compétent dans les procédures de RCP et les procédures médicales connexes.

2. Illustration du produit

Le kit défibrillateur se compose du défibrillateur, de la télécommande, des électrodes, des capteurs de pads, du manuel d'instructions, de l'adaptateur secteur et du sac de rangement.

2.1 Le formateur

2.1.1. Vue de face



Fig. 1 Vue de face



Fig.2 Couverture ouvert

1) Manche

2) Couverture

Lorsque vous ouvrez le couvercle, le défibrillateur DAE sera allumé; lorsque vous fermez le couvercle, le défibrillateur sera éteint.

3) USB Interface

Il est utilisé pour mettre à niveau le logiciel.

4) Prise d'électrode :

Il est utilisé pour connecter le câble relié aux électrodes.

5) Écran d'affichage

Lorsque le défibrillateur est en marche, l'écran affiche l'état de fonctionnement.



6) Bouton d'alimentation

Allumez le trainer en ouvrant le couvercle, pendant cet état, appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre le trainer

7) Bouton de choc

Appuyez sur ce bouton pour administrer un choc. Le bouton clignote lorsque le choc est conseillé.

8) Bouton de réglage

Lorsque le trainer est sous tension, maintenez enfoncé ce bouton de réglage pendant 3 secondes pour accéder à l'interface de réglage. Appuyez ensuite sur le bouton qui descend  ou le bouton montant  pour sélectionner la langue, le métronome, le bracelet CPR et les paramètres système. Une fois le réglage terminé, maintenez enfoncé le bouton Réglage pendant 3 secondes pour quitter l'interface de réglage.

9) Bouton montant

Lorsqu'il est sur l'interface de travail, l'utilisateur peut appuyer sur ce bouton pour choisir différents scénarios;

Lorsqu'il est sur l'interface de configuration, l'utilisateur peut appuyer sur ce bouton pour changer la sélection.

10) Bouton descendant

Lorsqu'il est sur l'interface de travail, l'utilisateur peut appuyer sur ce bouton pour choisir différents

scénarios ;

Lorsqu'il est sur l'interface de configuration, l'utilisateur peut appuyer sur ce bouton pour changer la sélection.

11) Haut-parleur

12) Fenêtre de réception du signal

Lorsque vous utilisez la télécommande, pointez-la sur cette fenêtre pour contrôler le trainer.

2.1.2 Vue arrière

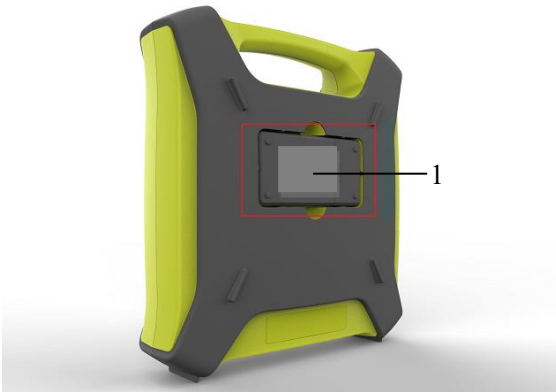


Fig.3 Vue arrière



Fig.4 Retirer la télécommande

1) Télécommande

La télécommande est stockée à l'arrière du trainer. L'utilisateur peut la retirer lors de la formation.

2.1.3 Vue de dessous



Fig.5 Vue de dessous



Fig.6 Retirez le module de batterie

1) Module de batterie

Le module de batterie est rechargeable. Lorsque la charge est nécessaire, l'utilisateur peut retirer le module de batterie du trainer et le connecter à l'adaptateur secteur pour la charge.

2.2 L'écran d'affichage













Fig.7 Écran d'affichage

Non.	Explication
1	 Indique les temps de choc que le trainer a délivrés « 0 » signifie pas de choc
2	 Indique que le trainer est actuellement en mode semi-automatique ;  Indique que le trainer est actuellement en mode entièrement automatique.
3	 Indique que le trainer est connecté au bracelet de RCP;  Indique que le trainer n'est pas connecté au bracelet de RCP.
4	 « s » est l'abréviation de Scénario, le nombre 0-9 signifie le scénario 0 au scénario 9.
5	 Indique que le trainer est actuellement en mode pédiatrique et utilise des électrodes pour enfants;  Indique que le trainer est actuellement en mode adulte et utilise des électrodes pour adultes.
6	 Indique le temps utilisé depuis sa mise sous tension.

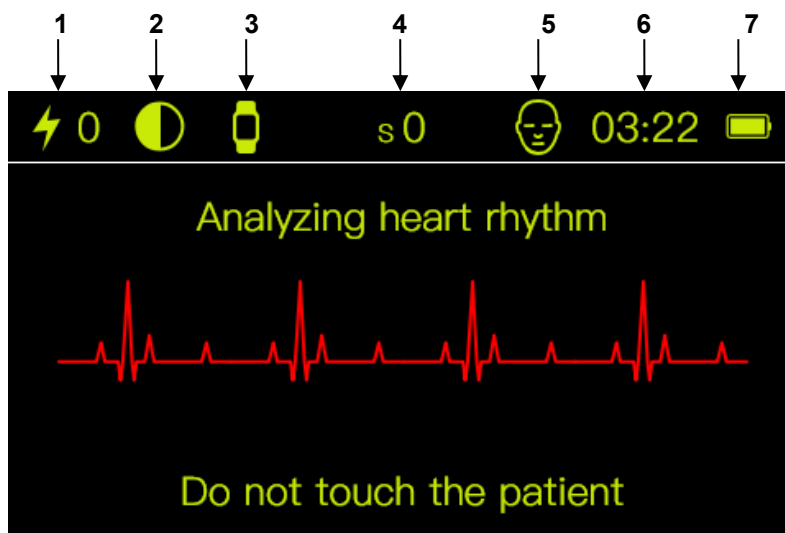

2.3 La télécommande

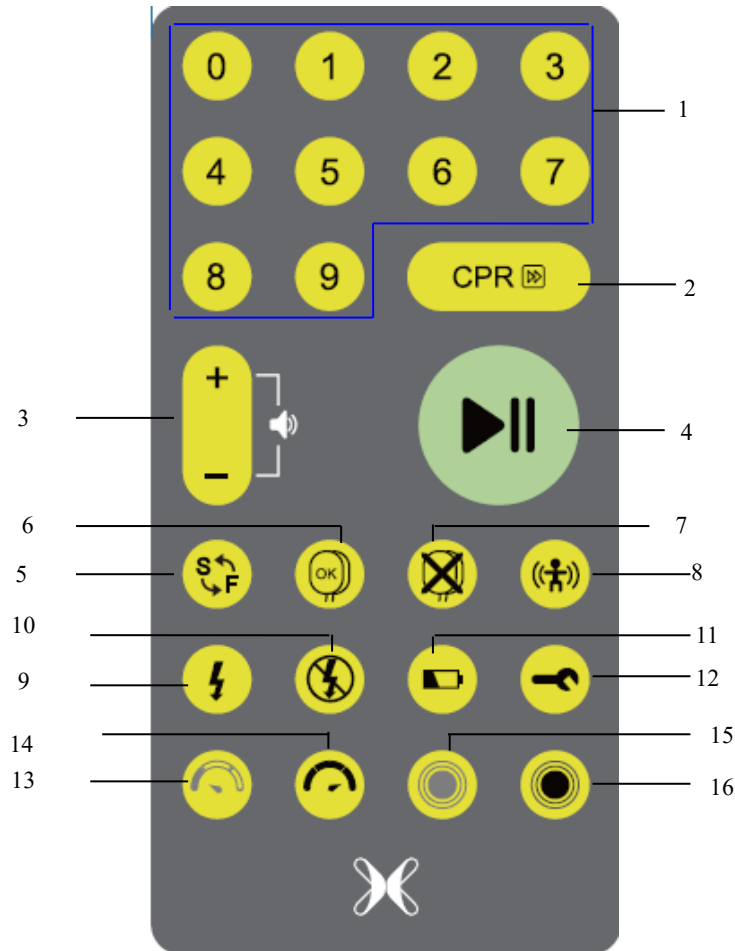


Figure. 6 Télécommande

1) Boutons de scénario

Appuyez sur ces boutons pour sélectionner le scénario de base entre 0 et 9 (voir le tableau 3 pour plus de détails sur chaque scénario) ;

2) Bouton d'arrêt de la RCP

Si vous appuyez sur ce bouton pendant le processus de RCP, vous mettez fin au processus de RCP à l'avance et passerez directement au processus suivant.

3) Bouton Volume +/-

Appuyez sur le bouton + pour augmenter le volume;

Appuyez sur le bouton – pour réduire le volume.

4) Bouton Lecture/Pause

Lorsque le trainer fonctionne, appuyez sur ce bouton, le trainer entrera dans l'état de pause;

Lorsque le trainer est en état de pause, appuyez sur ce bouton, le trainer continuera de fonctionner.

5) Bouton semi / entièrement automatique

Appuyez sur ce bouton pour choisir entre un scénario semi-automatique ou un scénario entièrement automatique.

6) L'électrode simulée est bien connectée

Appuyez sur ce bouton pendant l'entraînement, le défibrillateur entre dans les électrodes le bon programme, puis suivez les instructions vocales pour l'entraînement.

7) L'électrode simulée n'est pas bien connectée :

Appuyez sur ce bouton pendant l'entraînement, le défibrillateur vous demandera « Appuyez fermement les électrodes sur la poitrine nue du patient », puis vous dira « mauvais contact des électrodes » et

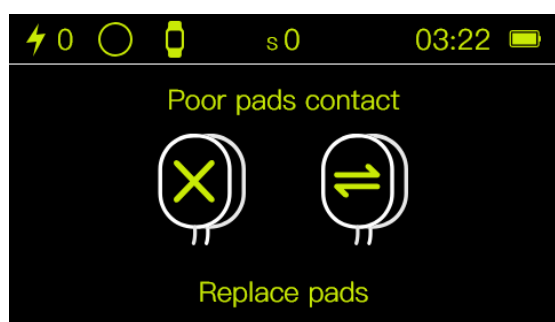
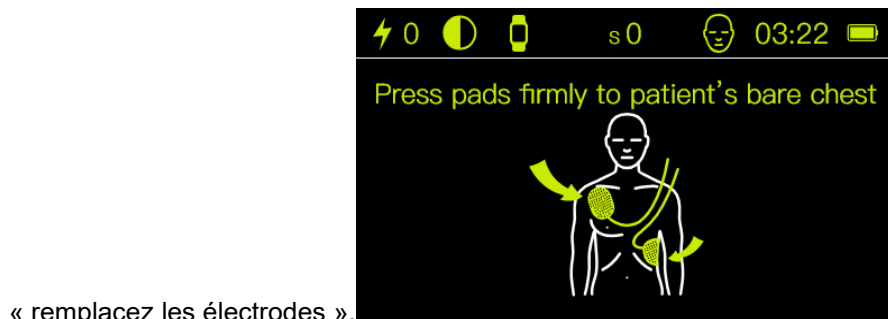


Fig. 7

Fig. 8

8) Simuler les interférences de mouvement :

Appuyez sur ce bouton lors de la première analyse du rythme cardiaque, le défibrillateur demande « Analyse interrompue (Fig. 9), Arrêtez tout mouvement (Fig. 10) »; appuyez sur ce bouton lors de la deuxième analyse du rythme cardiaque, le défibrillateur demande « Arrêter tout mouvement (Figure 10), Impossible d'analyser (Figure 11) »



Photo 9

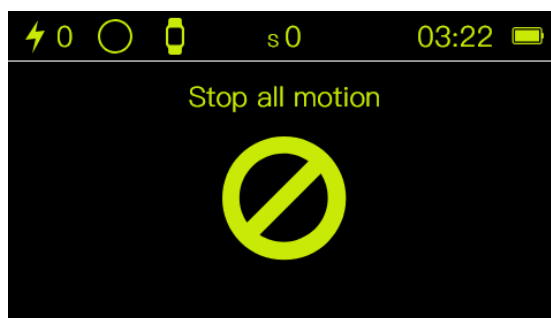


Photo 10



Photo 11

9) **Simulez un rythme choquant :**

Appuyez sur ce bouton pendant l'entraînement, le défibrillateur entre dans un programme de rythme choquant, puis s'entraîne selon les invites vocales.

10) **Simulez un rythme non choquable :**

Appuyez sur ce bouton pendant l'entraînement, le défibrillateur entre dans un programme rythmique non choquable, puis s'entraîne selon les invites vocales.

11) **Simuler une batterie faible**

Dans l'utilisation normale du trainer, appuyez sur ce bouton, l'écran du trainer indique une batterie faible. Si vous appuyez à nouveau sur ce bouton, vous serez invité à remplacer la batterie.



Figure. 12 Fig. 13

12. **Simuler une erreur système :**

Dans l'utilisation normale du défibrillateur, appuyez sur ce bouton, l'écran du défibrillateur affiche « System Error ».

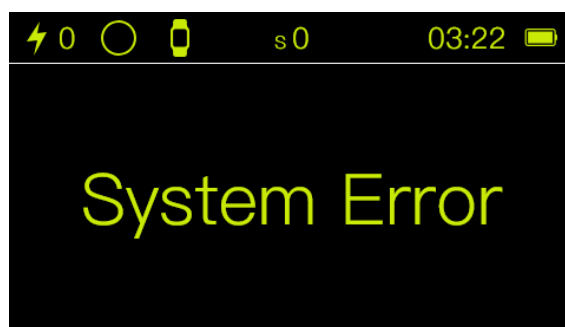


Figure. 14

13. **Simulez que la compression est trop lente:**

Pendant le processus de RCR, lorsque vous appuyez sur ce bouton, l'écran du défibrillateur vous invite à pousser plus vite.

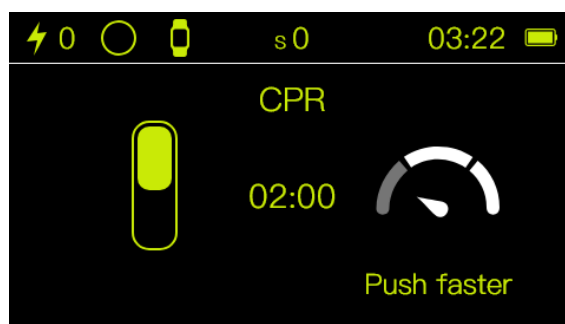


Figure. 15

14. **Simulez la compression trop rapide:**

Pendant le processus de RCP, lorsque vous appuyez sur ce bouton, l'écran du défibrillateur vous invite à pousser plus lentement.

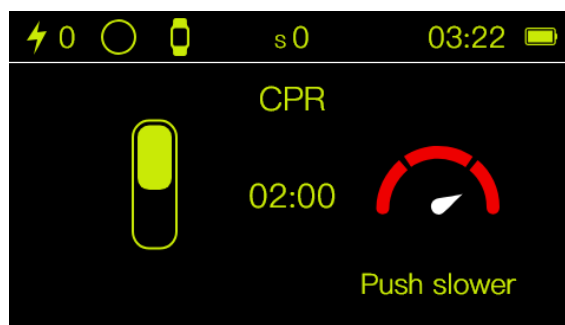


Figure. 16

15. **Simulez que la compression est trop douce :**

Pendant le processus de RCP, lorsque vous appuyez sur ce bouton, l'écran du défibrillateur vous invite à appuyer plus fort.



Figure. 17

16. **Simuler la compression est trop difficile:**

Pendant le processus de RCP, lorsque vous appuyez sur ce bouton, l'écran du défibrillateur vous invite à appuyer plus doucement.

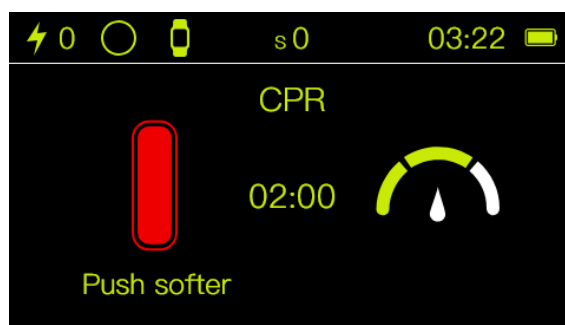


Figure. 18

2.4 Accessoires

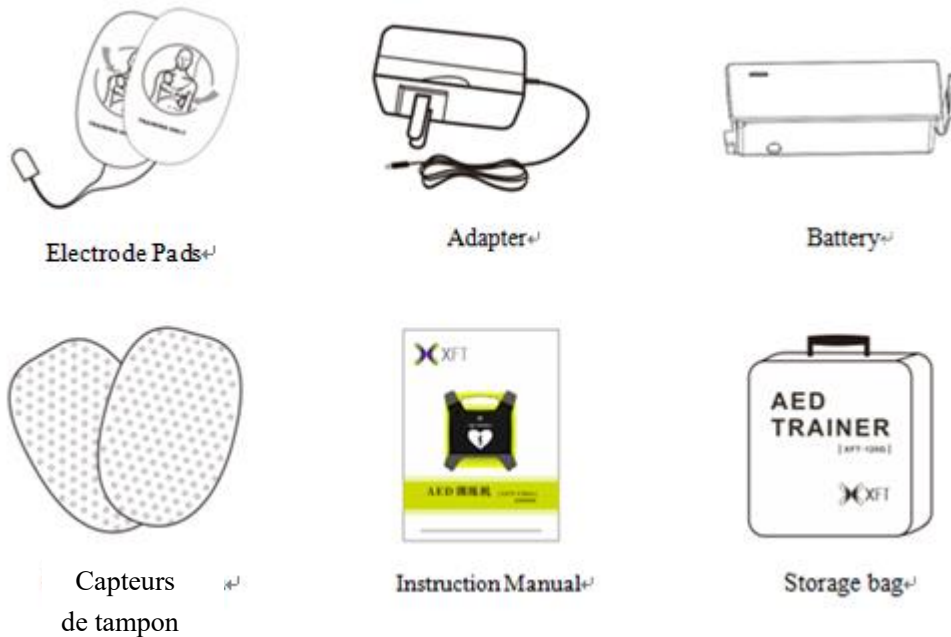


Fig. 19

3. Mode d'emploi

3.1 Préparation

3.1.1 Placement des électrodes

Retirez l'électrode de l'emballage et placez-la sur le mannequin.

Remarque : Si le mode adulte est utilisé, les électrodes adultes sont fixées à la position indiquée à la figure 20; si le mode enfant est utilisé, les électrodes enfants sont fixées à la position indiquée à la figure 21.

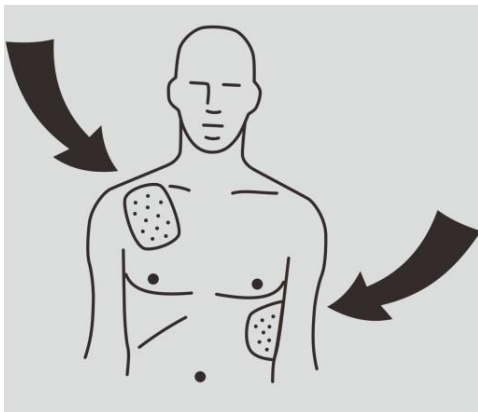


Figure. 20 Placement d'électrodes pour adultes enfants

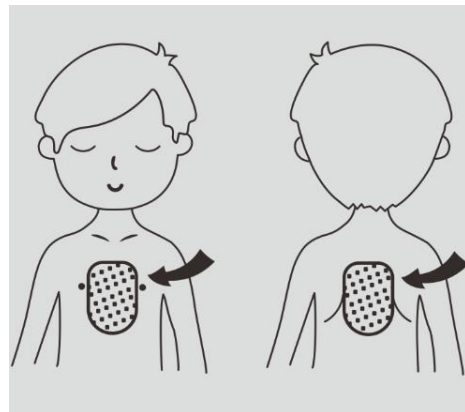


Fig. 21 Placement des électrodes pour enfants

3.1.2 Utilisation avec le bracelet de RCP

Si vous souhaitez utiliser le bracelet RCP avec le défibrillateur, vous devez connecter le bracelet CPR à celui du défibrillateur. Allumez d'abord celui du défibrillateur, puis allumez le bracelet CPR, après quoi le bracelet CPR se connectera automatiquement à celui du défibrillateur. Si le bracelet de RCP ou celui du défibrillateur est éteint, la connexion entre les deux appareils sera interrompue. Si vous souhaitez vous reconnecter, vous

devez redémarrer les deux.

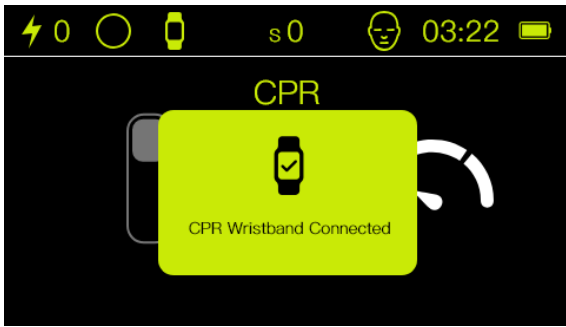


Fig. 22 le défibrillateur et le bracelet de RCP connectés

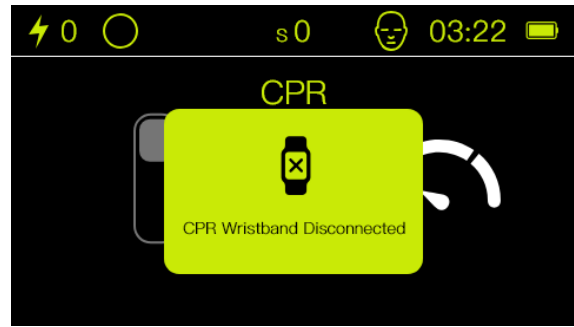


Fig. 23 Bracelet de RCP et le défibrillateur déconnectés.

L'état de la connexion affiché sur l'écran du bracelet CPR est le suivant :

Affichage de l'écran du bracelet de RCP	Explication
	Icône non connectée : L'icône s'affiche lorsque le bracelet de RCP n'est pas connecté au trainer. Lorsque le bracelet de RCP est allumé et que le trainer n'est pas allumé, le bracelet CPP recherchera le trainer pour se connecter. Lorsque le trainer n'est pas connecté, l'écran du bracelet CPP affiche cette icône.
	Icône connectée : L'icône s'affiche lorsque le bracelet de RCP est connecté au trainer. Allumez d'abord le trainer , puis le bracelet de RCP. Ces deux appareils se connecteront automatiquement; une fois la connexion établie, l'icône s'affiche sur l'écran du bracelet de RCP.
	Icône Déconnecter : L'icône s'affiche lorsque le bracelet de RCP est déconnecté de l'entraîneur. Lorsque le bracelet de RCP est connecté à celui du défibrillateur, si celui du trainer est éteint, cette icône s'affiche sur l'écran du bracelet RCP.

3.2 Mode d'entraînement Power on et Select

Ouvrez le couvercle, le voyant du bouton d'alimentation est allumé, puis sélectionnez le scénario d'entraînement via la télécommande. L'écran d'affichage du formateur affiche le numéro de mode de scénario actuellement sélectionné et effectue les opérations connexes en fonction de l'invite vocale. Le dernier mode

d'entraînement sélectionné sera mémorisé comme le mode par défaut pour le prochain démarrage.



Fig. 24

3.3 Electrode de connexion

- 1) Retirez les électrodes (les électrodes pour adultes sont préconnectées au défibrillateur);
- 2) Placez les électrodes sur le mannequin selon l'illustration sur les électrodes;
- 3) Suivez les instructions vocales pour effectuer les opérations connexes.

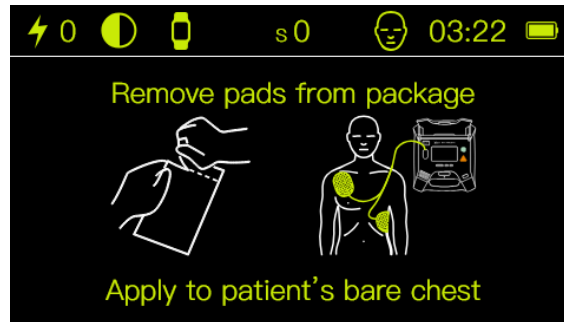


Figure. 25 Electrode de connexion

Remarque: Il existe deux types d'électrodes d'entraînement: le électrode pour adultes et les électrodes pour enfants. Les électrodes pour l'entraînement sont similaires en apparence aux électrodes utilisées dans les DAE opérationnels, mais ne conduit pas les chocs à haute tension. Par conséquent, les électrodes d'entraînement sont uniquement destinées à l'entraînement et ne doivent pas être connectées au DEA pour les premiers soins.

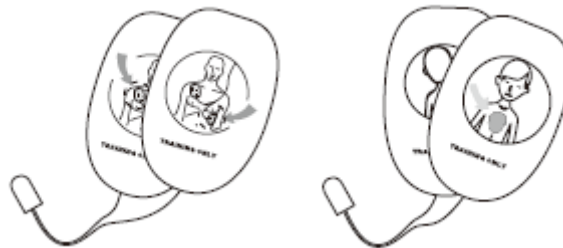


Fig. 26 Pad d'électrode pour adultes et d'électrode pour enfant

- Ne pliez pas et n'étirez pas les fils d'électrode.
- Lorsque vous retirez l'électrode de l'entraîner, appuyez sur la borne et maintenez-la enfoncée pour la retirer.
- La valeur par défaut de l'usine est d'utiliser l'électrode adulte, une extrémité a été connectée au le défibrillateur; Si vous devez remplacer par l'électrode enfant, retirez d'abord l'électrode adulte, puis remplacez-la par l'électrode d'un enfant. Lorsque vous utilisez l'électrode d'un enfant, veuillez faire attention à la différence entre la méthode de placement de l'électrode adulte (voir 3.1.1).

3.4 Suivre la voix du défibrillateur

Selon le mode d'entraînement sélectionné, l'opération est effectuée en fonction de la rapidité d'élocution du défibrillateur.




Fig. 27 Suivez les instructions vocales pour opérer



3.5 Interface de réglage


Si l'utilisateur a besoin de plus de paramètres, il peut accéder à la page des paramètres pour définir les paramètres associés.



3.5.1 Réglage de la langue


1) Ouvrez le couvercle du trainer pour l'allumer

2) Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes ce bouton  pour entrer dans l'interface de réglage


3) Sélectionnez l'option Langue en appuyant sur le bouton  ou 

4) Appuyez sur  pour entrer dans la page de réglage de l'option de langue

5) Sélectionnez la langue souhaitée en appuyant sur le bouton  ou 

6) Appuyez sur  pour confirmer la sélection

7) Appuyez sur le bouton  ou  pour revenir à la page de démarrage du réglage

8) Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes ce bouton  pour quitter l'interface de réglage.

Suivez ensuite les instructions vocales dans l'ordre normal de l'entraînement.

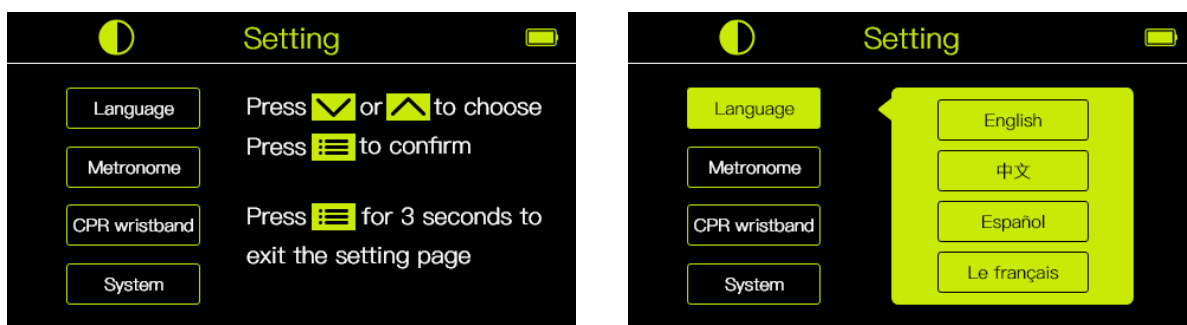












Fig. 28 Paramètres de langue

3.5.2 Réglage du métronome

1) Ouvrez le couvercle du le défibrillateur pour l'allumer

- 2) Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes ce bouton  secondes pour entrer dans l'interface de réglage
 - 3) Sélectionnez l'option Métronome en appuyant sur le bouton  ou 
 - 4) Appuyez sur  pour entrer dans la page de configuration du métronome
 - 5) Sélectionnez le métronome souhaité en appuyant sur le bouton  ou 
 - 6) Appuyez sur  pour confirmer la sélection
 - 7) Appuyez sur le bouton  ou  pour revenir à la page de démarrage du réglage
 - 8) Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes ce bouton  pour quitter l'interface de réglage.
- Suivez ensuite les instructions vocales dans l'ordre normal de l'entraînement.

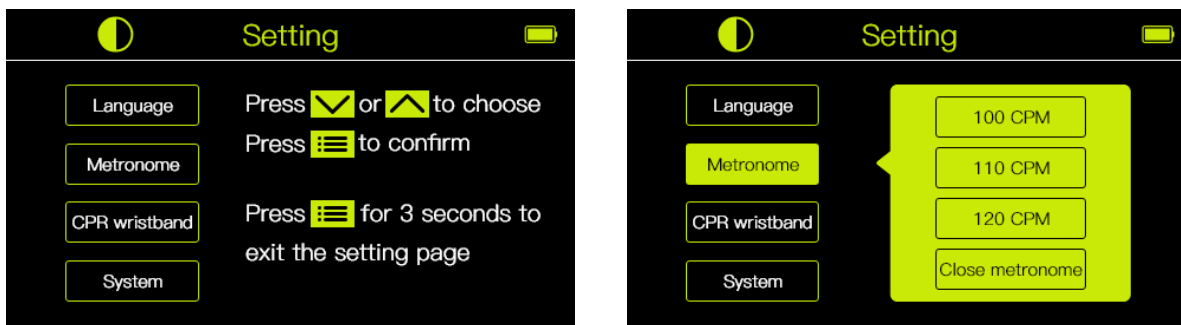












Figure. 29 Réglage du métronome

3.5.3 Réglage du bracelet de RCP

- 1) Ouvrez le couvercle du trainer pour l'allumer
 - 2) Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour entrer dans l'interface de réglage 
 - 3) Sélectionnez le bracelet CPP en appuyant sur le bouton  ou 
 - 4) Appuyez sur  pour entrer dans la page de réglage du bracelet RCP
 - 5) Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant sur le bouton  ou 
 - 6) Appuyez sur  pour confirmer la sélection
 - 7) Appuyez sur le bouton  ou  pour revenir à la page de démarrage du réglage
 - 8) Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes ce bouton  pour quitter l'interface de réglage.
- Suivez ensuite les instructions vocales dans l'ordre normal de l'entraînement.

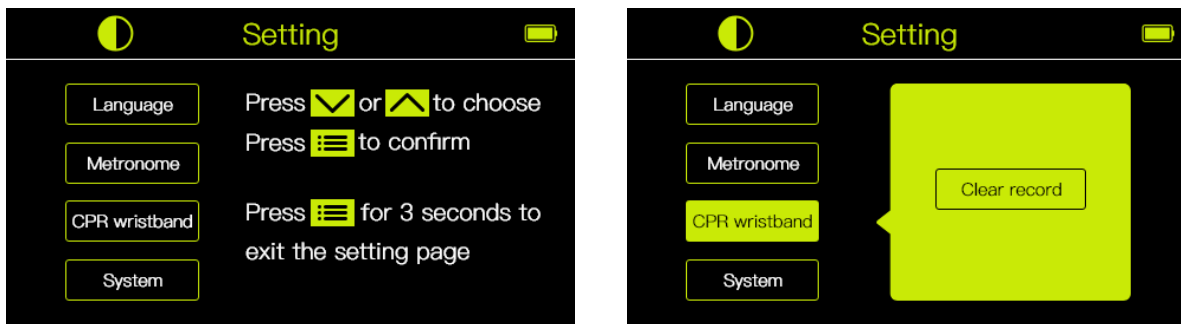





Figure. Réglage du bracelet 30 RCP



3.5.4 Réglage du système


1) Ouvrez le couvercle du trainer pour l'allumer



2) Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes ce bouton  pour accéder à l'interface de configuration du système


3) Sélectionnez l'option Système en appuyant sur le bouton  ou 

4) Appuyez sur  pour accéder à la page Paramètres système

5) Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant sur le bouton  ou 

6) Appuyez sur  pour confirmer la sélection

7) Appuyez sur le bouton  ou  pour revenir à la page de démarrage du réglage

8) Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes ce bouton  pour quitter l'interface de réglage. Suivez ensuite les instructions vocales dans l'ordre normal de l'entraînement.

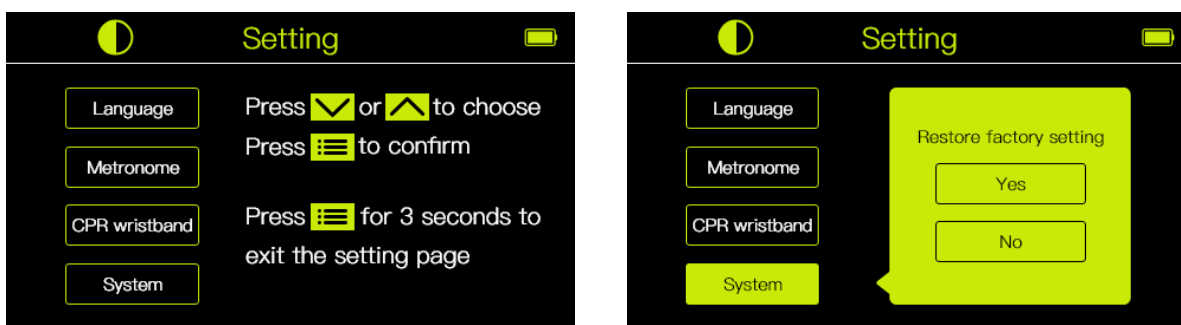


Figure. 31 Configuration du système

3.6 Arrêt S

Lorsque la formation est terminée, fermez le couvercle du formateur pour éteindre l'appareil.

Veuillez noter que :

- 1) S'il est dans l'interface de réglage pendant plus de 8 minutes, il s'éteindra automatiquement.
- 2) Si le trainer est en pause pendant 8 minutes sans aucune opération, il s'éteindra automatiquement.

4. Maintenance du produit

4.1 Maintenance du défibrillateur

- Si le traineur est sale, essuyez avec un chiffon doux avec de l'eau ou un détergent neutre. Essorez-le soigneusement et essuyez l'unité principale.
- N'essuyez pas l'unité principale avec un diluant, de la benzine, etc.
- Ne pas essuyer l'appareil principal avec d'autres préparations volatiles.
- Ne laissez pas un liquide tel que de l'eau s'écouler à l'intérieur de l'unité principale.
- Ne pas entreposer dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil, à une température élevée, à l'humidité, à la poussière ou à un gaz corrosif.
- Enregistrez l'unité principale, la télécommande, les électrodes, l'adaptateur secteur et le manuel avec un kit de rangement.

4.2 Entretien des électrodes

- Les électrodes doivent être maintenues propres pour éviter la poussière, les substances huileuses, les substances collantes, les substances collantes et autres contaminants.
- Ne grattez pas la surface avec des ongles, des pinceaux, etc.
- Ne vous lavez pas fréquemment. Veuillez ne pas utiliser de détergent ou d'eau chaude pour le nettoyage.
- Ne pas entreposer dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil, à une température élevée, à l'humidité, à la poussière ou à un gaz corrosif.

4.3 Démontage et entretien de la batterie

1) L'installation de la batterie d'entraînement : Insérez la batterie comme indiqué



Figure. 32 L'installation de la batterie d'entraînement

2) La charge de la batterie de formation : Lorsque la batterie est épuisée, veuillez charger la batterie à temps.



Figure. 33 La charge de la batterie d'entraînement

* Après utilisation pendant un certain temps, si le volume n'est pas normal ou ne fonctionne pas correctement, la batterie peut être épuisée. Veuillez remplacer la batterie ou la charger.

Batterie Installation pour la télécommande:

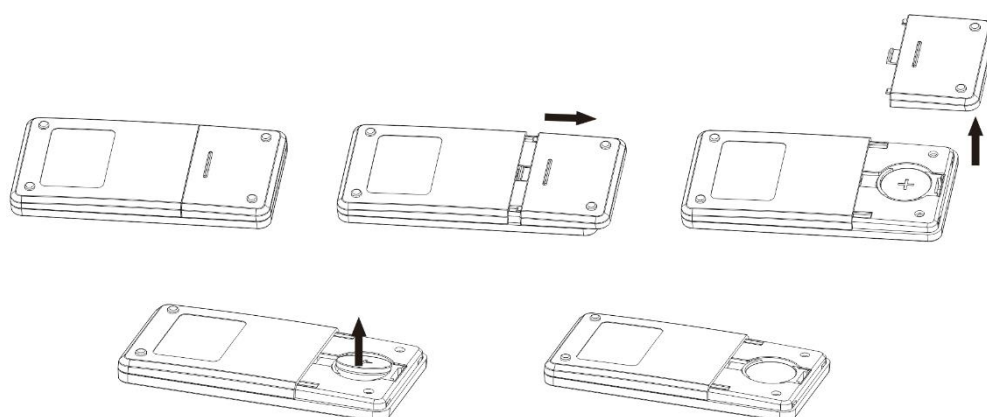


Figure. 34 Schéma de retrait de la batterie de la télécommande

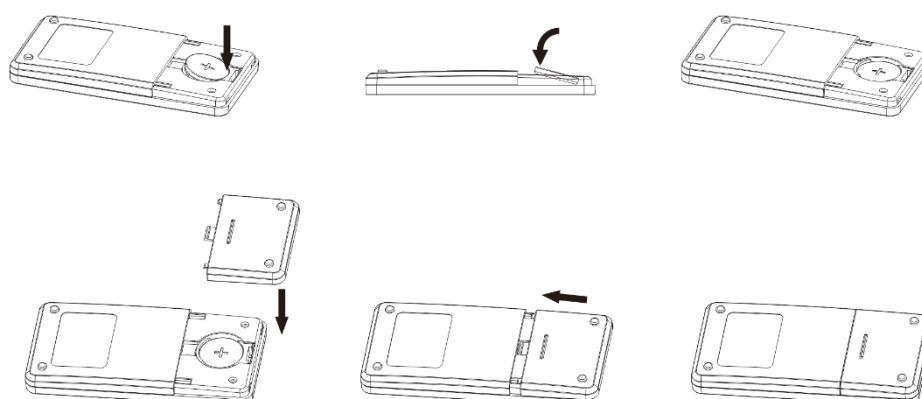


Figure. 35 Schéma d'installation de la batterie de la télécommande

* Notez que l'anode de la batterie est vers le haut lorsque la batterie est installée. Après avoir utilisé pendant un certain temps, si la réponse de l'entraîneur à la télécommande est retardée ou ne répond pas, la batterie peut être épuisée. S'il vous plaît le remplacer par un nouveau

4) Utilisation en toute sécurité des batteries rechargeables :

- ◆ Ne chargez pas / déchargez plus que le courant spécifié.
- ◆ Ne court-circuitez pas la batterie / batterie, car cela pourrait endommager de manière permanente la batterie / batterie.
- ◆ Ne brûlez pas ou ne détruisez pas la batterie / batterie.
- ◆ N'exposez pas la batterie à des conditions défavorables telles que des températures extrêmes, des cycles profonds et une surcharge, sinon la durée de vie de la batterie peut être réduite.
- ◆ Rangez la batterie / batterie dans un endroit frais et sec.
- ◆ Tenir à l'écart des enfants.

※Instructions d'entretien de la batterie rechargeable

Charge et décharge périodiques: Si la batterie n'est pas utilisée pendant une longue période (lorsque la batterie est stockée pendant plus de 6 mois), il est recommandé de décharger complètement la batterie, puis de la recharger. Si la batterie fuit, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le fournisseur pour l'élimination.

4.4 Conditions de fonctionnement et d'entreposage

Condition de travail

Température: 5 °C -40 °C

Humidité: ≤80% (sans condensation)

Pression atmosphérique: 86kPa-106kPa

Conditions d'entreposage

Température: -20 °C -55 °C

Humidité: ≤93% (sans condensation)

Pression atmosphérique: 70 kPa a-106 kPa

5. Spécifications et contenu du produit

5.1 Le formateur

Modèle: AED trainer Daexal

Nom du produit: AED Trainer

Puissance: DC 7.4V / 2600mAh, batterie au lithium rechargeable

Courant d'arrêt: ≤10μA

Courant de travail: ≤500mA

Taille: 253 * 230 * 71mm

Poids: 865±35g

Batterie au lithium rechargeable: ICR18650, 7.4V 2600mAh, 37 * 67 * 19mm

5.2 Télécommande

Alimentation: DC 3.0V (pile bouton CR2032)

Courant d'arrêt: ≤5μA

Courant de travail: ≤10mA

Taille: 102 * 52 * 11mm

Poids: 30±5 g

5.3 Contenu du produit

Tableau 1

Non.	Contenu	Quantité	Unité	Remarques
1	Le défibrillateur	1	PC	--
2	Télécommande	1	PC	--
3	Électrodes pour adultes	1	pair	--
4	Électrodes pour enfants	1	pair	--
5	Capteurs de tampon	1	pose	--

			r	
6	Bracelet de RCP	1	PC	Optionnel
7	Pile	1	PC	Balle de recharge
8	Adaptateur	1	PC	--
9	Manuel	1	PC	--
10	Sac de rangement	1	PC	--

Tableau 2 : Numéro de référence de commande des accessoires

Non.	Accessoires	Ref. Non
1	Le défibrillateur	FOR555
2	Télécommande	FOR559
3	Électrodes pour adultes	FOR557
4	Électrodes pour enfants	FOR558
5	Capteurs de tampon	4130010060
6	Bracelet de RCR	FOR560
7	Pile	FOR556
8	Adaptateur	1140210033
9	Manuel	4010701001
10	Sac de rangement	FOR562

Tableau 3 : 10 scénarios préprogrammés dans XFT-120G AED Trainer

Scénarios	Description	Opération
0	Fibrillation ventriculaire- Avec conversion à choc unique	Rythme choquant 1 choc Rythme non choquant
1	Fibrillation ventriculaire- Avec amortisseurs multiples requis pour la conversion	Rythme choquant 4 chocs Rythme non choquant
2	Compétences en dépannage - Tampons de défibrillation	Mauvaise connexion du pad Rythme choquant 1 choc Rythme non choquant
3	Fibrillation ventriculaire- Avec deux amortisseurs requis pour la conversion	Rythme choquant 2 chocs Rythme non choquant
4	Rythme non choquant	Rythme non choquant à travers

5	Fibrillation ventriculaire- Avec deux amortisseurs requis pour la conversion	Rythme choquant 2 chocs Rythme non choquant
6	Fibrillation ventriculaire- Avec trois amortisseurs requis pour la conversion	Rythme choquant 3 chocs Rythme non choquant
7	Compétences en dépannage - Tampons de défibrillation avec deux amortisseurs requis pour la conversion	Mauvaise connexion du pad Rythme choquant 2 chocs Rythme non choquant
8	Fibrillation ventriculaire	Fibrillation ventriculaire par
9	Compétences en dépannage - Mouvement, batterie faible, avec un amortisseur requis pour la conversion	Artefacts de mouvement Rythme choquant 1 choc Rythme non choquant

6. Service après-vente

1. Le produit bénéficie d'une garantie de deux ans à compter de la date d'achat.
2. DAEXAL ne fournira pas de réparation gratuite pour les dysfonctionnements causés par les comportements suivants:
 - Démonter ou modifier le produit sans autorisation.
 - Souffler ou laisser tomber accidentellement le produit pendant l'utilisation ou le transport.
 - Manque d'entretien raisonnable.
 - Ne pas fonctionner conformément aux instructions.
 - Réparé par un atelier de réparation non autorisé.
3. Lorsque vous demandez un service de garantie, veuillez prendre la carte de garantie.
 - Il est facturé selon la stipulation du service de réparation de la garantie.
 - Veuillez contacter DAEXAL si vous avez besoin d'un service de garantie.

Date: 1/6/2023

N° du document : AED Trainer DAEXAL